



Sz.S.POO. SZP. 3810.104.2025

Brzozów, 02.12.2025 r.

Dotyczy: „Dostawy odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów”- Znak sprawy: **SZSPOO.SZP.3810.104.2025.**

W związku z pytaniami złożonymi w niniejszym postępowaniu, zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Opis przedmiotu zamówienia: *pkt 4 4. Odbiór i utylizacja odpadów z aparatów na koszt Dostawcy.*

W rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawy o odpadach, wytwórca odpadów jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami, w tym do ich prawidłowej klasyfikacji i ewidencji. Obowiązek ten obejmuje wystawienie Karty Przekazania Odpadu (KPO) za pośrednictwem Bazy Danych o Odpadach (BDO), zgodnie z obowiązującymi przepisami. W tym celu, wytwórca odpadów powinien posiadać aktualny wpis do rejestru BDO oraz indywidualny numer rejestrowy. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu przejęcia przez naszą firmę obowiązku odbioru, transportu i zarządzania wytworzonymi odpadami. Proponujemy aby całość logistyki odbioru i dalszego zagospodarowania odpadów (w tym koszty odbioru i przetwarzania) pozostała w gestii Zamawiającego. Nasza firma deklaruje możliwość dostawy 2000 sztuk pojemników (wiaderek), przeznaczonych do bezpiecznego przelewania i magazynowania odpadów bezpośrednio przy analizatorach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w miejscu wymaganych deklaracji CE wykonawca dołączył oświadczenie o posiadaniu takich dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. i zapewnieniu przedstawienia ich na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych od daty wezwania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 3. W przypadku braku zgody na odstąpienie od wymogu dołączenia deklaracji CE do oferty czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie tychże deklaracji zgodności UE wyłącznie w języku angielskim? *Uzasadnienie: Przedstawienie deklaracji zgodności UE jedynie w języku angielskim spełnia obowiązujące normy prawne. Zgodnie z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, nie ma bowiem konieczności dostarczania deklaracji zgodności UE w języku polskim. W przypadku wyrobów przeznaczonych bądź udostępnionych do stosowania przez użytkowników niebędących laikami, deklaracja zgodności UE może być wyrażona w języku polskim lub języku angielskim. Wyjątkiem są informacje przeznaczone dla pacjenta, które podaje się jedynie w języku polskim lub wyraża się za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. Podkreślamy, że informacje wyrażone w języku angielskim w ww. dokumencie są przedstawione w sposób czytelny i w pełni zrozumiały, co zapewnia zgodność z wymaganiami prawnymi oraz nie wpływa*

na czytelność i przejrzystość dokumentów. Takie podejście może również przyczynić się do zwiększenia efektywności i uproszczenia procesu przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4. Czy zamawiający udostępni w swoich zasobach dostęp do sieci lokalnej w celu integracji z LIS oraz zapewni dostęp do internetu? Oferowane analizatory i systemy wymagają stałego połączenia z internetem, które umożliwi aktualizację licencji oprogramowania, pobieranie danych dotyczących odczynników, kontroli, kalibratorów, serwis zdalny. Wymagane jest połączenie z poniższymi serwerami na sprecyzowanych portach w poniższej tabeli. Poniżej znajduje się również poglądowy schemat połączeń rozwiązań diagnostycznych (analizatorów).

URL	IP	Port	Typ
*.navify.com	193.58.155.0/24	443	CloudFlare
*.navify.com	193.228.103.0/24	443 (514/541)	CloudFlare
gas1.remoteservice.navify.com	193.228.103.101	443	Direct
gas2.remoteservice.navify.com	193.228.103.102	443	Direct
gas3.remoteservice.navify.com	193.228.103.103	443	Direct
fmg-emea.remoteservice.navify.com	193.228.103.115	514/541	Direct

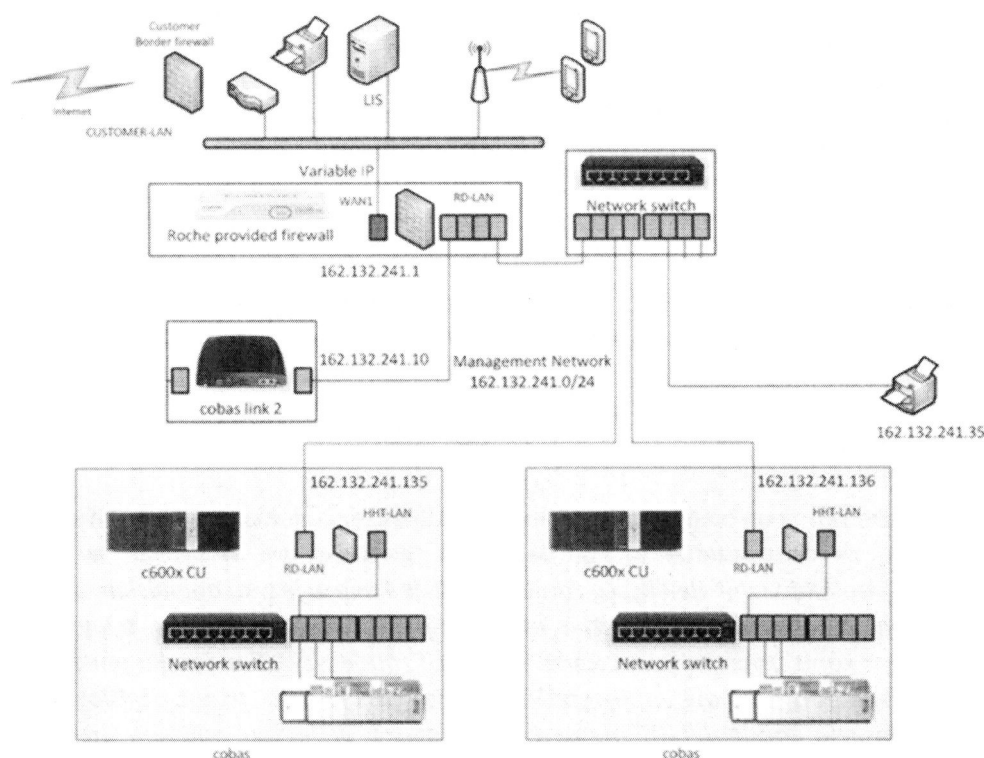

Odpowiedź: TAK.

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu podłączenia analizatora do sieci Zamawiającego (LIS) oferowanych urządzeń do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Uzasadnienie: Z uwagi na długie terminy realizacji podłączeń urządzeń przez dostawcę Państwa systemu LIS, które nie są zależne od nas jako Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Czy Zamawiający zgodzi się by Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za opóźnienie instalacji, które wynikają ze zmian podjętych przez Zamawiającego już w czasie jej trwania, w szczególności dotyczy: zmiany konfiguracji lub umiejscowienia aparatów w pomieszczeniu laboratorium

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień oraz na zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy (strona internetowa)?

Uzasadnienie: Składanie zamówień, zgłaszanie reklamacji odczynników i awarii aparatu przez aplikację Wykonawcy umożliwi Zamawiającemu przeglądanie historii wpisów, śledzenie statusu zgłoszeń i wysyłki zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8. par. 1 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie dokumentów w formie elektronicznej (e-mail, strona internetowa)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9. par. 1 ust. 5 Zwracamy się z prośbą o dodanie sformułowania "Umowę można rozwiązać po wyczerpaniu 80% wartości umowy."

Zgodnie z definicji Art. 7 Pkt 32, Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, umowa o zamówienie publiczne jest umową odpłatną.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10. par. 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy urządzeń

do 21 dni od daty podpisania umowy, a termin jego instalacji 7 dni od daty dostarczenia?

Uzasadnienie: Z uwagi na konieczność sprowadzenia analizatora z zagranicy bezpośrednio od producenta oraz mając na uwadze skomplikowane procedury celne z tym związane, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy w zaproponowany w sposób.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11. par. 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa "dni" na "dni robocze"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 .Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu? Naprawy aparatury w ciągłym użytkowaniu są normalnym

zjawiskiem, a w związku z tym, w pierwszej kolejności Wykonawca powinien mieć zapewnioną możliwość przywrócenia sprawności sprzętu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu ew. wymiany części analizatora/analizatora na nowy do 10 dni roboczych? Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i złożone uwarunkowania logistyczno-techniczne realizacja dostawy nowego sprzętu lub produktu (części analizatora) wymaga niniejszego terminu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 13. par. 3 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie postanowienia poprzez wskazanie, że nie dotyczy sytuacji, w której nastąpił wzrost wykorzystania odczynników kalibratorów lub materiałów kontrolnych spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ i/lub nieprawidłowym wykorzystaniem Towaru, w sposób niezgodny z instrukcją?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14. par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do zakupu interwencyjnego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. par. 3 ust. 15 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia?

W przypadku braku zgody, zwracamy się z prośbą, aby gospodarka odpadami pozostawała po stronie Zamawiającego, tak jak wymagają tego przepisy, przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów odbioru na podstawie refaktury.

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.), uwzględniającymi zmiany w prowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1403), wytwórca odpadu, którym jest Zamawiający, zobowiązany jest do właściwego gospodarowania odpadami, w tym ponoszenia kosztów takiego gospodarowania, a także do ewentualnego zlecenia wykonania obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym odpowiednie uprawnienia oraz zezwolenia. Wykonawca nie jest podmiotem profesjonalnie świadczącym usługi gospodarowania odpadami, a w szczególności nie posiada uprawnień i zezwoleń na prowadzenie tego typu działalności. Tym samym nie może świadczyć usług gospodarowania odpadami w imieniu lub na zlecenie Zamawiającego. Zlecenie przez Zamawiającego, będącego wytwórcą odpadów, usług gospodarowania odpadami do Wykonawcy nie jest zgodne z brzmieniem ustawy o odpadach i może narazić Zamawiającego na konsekwencje wynikające z tej ustawy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa par. 3 ust. 15.

Pytanie 16. par. 5 ust. 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia, tak aby poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosił 5%.

Uzasadnienie: W projekcie umowy, zawarto postanowienia przewidujące waloryzację wynagrodzenia wykonawcy. Zostały one jednak sformułowane w taki sposób, że w przypadku umowy, która może być zawarta w wyniku tego postępowania przetargowego, waloryzacja wynagrodzenia będzie w praktyce niemożliwa z uwagi na to, że jej warunki wstępne nie mogą zaistnieć lub będzie miała pomijalną wartość. Takie sformułowanie postanowień powoduje, że mają one pozorny charakter, a zatem ich umieszczenie stanowi obejście normy wynikającej z art. 439 Prawa zamówień publicznych, która wymaga zamieszczenia skutecznych postanowień waloryzacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par. 5 ust.9 i otrzymuje brzmienie:

9. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na poziomie 10% w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia zawarcia umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia określa się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy o 10 %.

Pytanie 17. par. 5 ust. 11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia, tak aby Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 mogło się zmienić w wyniku zastosowania wszystkich Waloryzacji o maksymalnie 50% pierwotnej wartości Umowy?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18. par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację terminu płatności do 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. par. 6 ust. 5 Zapis w obecnym brzmieniu stanowi klauzulę abuzywną zgodnie z Art. 433 pkt 3) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Dlatego prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par. 6 ust.5 i otrzymuje brzmienie:

5. Sprzedający zobowiązuje się nie korzystać z prawa do wstrzymania dostaw na podstawie art. 552 k.c. lub jakiegokolwiek innego tytułu prawnego, nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności na podstawie podpisanego porozumienia.

Pytanie 20. par. 6 ust. 8 Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia, tak aby minimalny poziom realizacji umowy wynosił 80%, tj. zmniejszenie nie mogło przekroczyć 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, par.6 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Kupujący zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części przedmiotu sprzedaży. Sprzedającemu nie przysługują z tego tytułu roszczenia odszkodowawcze. Kupujący deklaruje realizację co najmniej 80 % wartości umowy.

Pytanie 21. par. 7 ust. 1 lit. a) Czy Zamawiający w niniejszym postanowieniu poprzez sformułowanie "zwłoki w realizacji zobowiązań Sprzedającego" ma na myśli wyłącznie zwłokę Wykonawcy w dostawach częściowych?

Odpowiedź: Tak Zamawiający miał na myśli dostawy częściowe.

Zamawiający modyfikuje zapisy par. 7 i dodaje ust.1 C):

1c) W przypadku niedostarczenia i niezainstalowania przedmiotu dzierżawy określonego w § 1 umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 umowy lub w przypadku niedostarczenia analizatora zastępczego w sytuacji określonej w załączniku do umowy zawierającym opis przedmiotu zamówienia, Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu karę umowną w wysokości: 500,00 PLN brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sformułowania na "niedostarczonej w terminie dostawy częściowej"?

Ponadto, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z "3%" do "0,3"?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 22. par. 7 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. par. 7 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację limitu kar umownych do „20%”?

Zaproponowana przez Zamawiającego wartość w sposób ewidentny odbiega od wartości przyjmowanych na rynku, nie stanowiąc mechanizmu ochronnego dla Wykonawcy, przewidzianego przez ustawodawcę. Należy zauważyć, że w sytuacjach, gdy szkoda przewyższa zastrzeżone kary, Zamawiający może dochodzić odpowiedzialności uzupełniającej na zasadach ogólnych.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy par. 7 ust.6 i otrzymuje brzmienie:

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą mogą dochodzić Strony wynosi 35 % wartości brutto umowy.

Pytanie 24.par. 8 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie na końcu postanowienia fragmentu:

„po uprzednim wezwaniu dodatkowym i wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego terminu co najmniej 5 dni roboczych.”? Odstąpienie, nawet częściowe, może skutkować po stronie Zamawiającego

potrzebą zmiany wykonawcy. Jednocześnie procedura naprawcza może skutecznie zapobiegać tego rodzaju przypadkom, umożliwiając dokończenie współpracy stron.

Ponadto, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów poprzez dodanie zdania:

„nie dotyczy okoliczności, gdy Zamawiający zalega z płatnościami za dostarczony towar ponad 30 dni licząc od terminu zapłaty. Wówczas Wykonawca będzie uprawniony do powstrzymania się ze spełnieniem obowiązku kolejnych dostaw do dnia zapłaty całości zaległych należności”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. par. 8 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25. brak regulacji w umowie: W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego dzierżawę aparatów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie, czy Zamawiający planuje powierzyć Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych?

Jeśli tak, czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia, oraz do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych według załączonego wzoru?

W przypadku braku zgody, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytania do udostępnionego wzoru umowy.

Odpowiedź: Umowę na powierzenie danych osobowych Wykonawca uzgodni z inspektorem danych osobowych po wyborze najkorzystniejszej ofert.

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza, występując jako zamawiający w niniejszym postępowaniu informuje, że, dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Treść działu nr XIV SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **10.03.2026 r.**”*

2. Treść działu nr XVIII pkt 4 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Termin składania ofert ustala się na dzień: **11.12.2025. r. godz.10:00.**”*

3. Treść działu nr XIX pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

*„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **11.12.2025 r. o godzinie 10:05.**”*

4. Treść rozdziału nr IX pkt nr 9 SWZ otrzymuje brzmienie:

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5. Zamawiający modyfikuje treść oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ.

Wzór zmodyfikowanego oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zmiany wprowadzone w Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z-ca DYREKTORA
d/s Administracyjno-Technicznych
mgr inż. Piotr Pilawski